



製品図

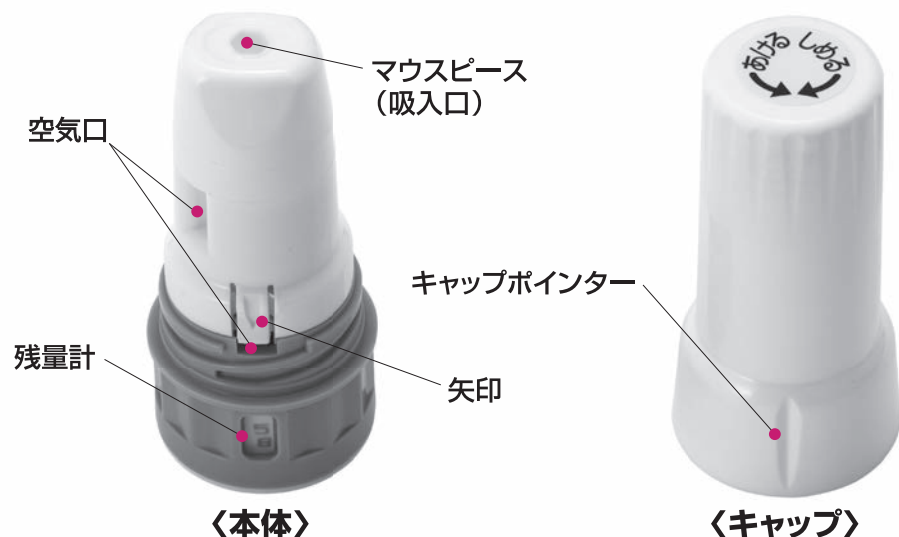


使用のはじめと残量計の見方

- 1) アルミ包装は**使用開始直前に開封**してください。
 - 2) 1回使用すると残量計の数字が1つ減ります。
- ※残量が少なくなったら早めの受診を心がけましょう。

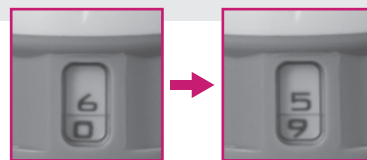

使い終わりの見分け方

残量計で“01”と表示された場合、最後の1吸入分であることが示されます。“01”の後は“00”と表示され、キャップがはずれなくなりますので、吸入器を各自治体の廃棄基準にしたがって廃棄してください。

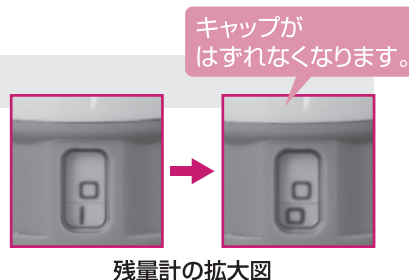

保管上の注意

- 1) 吸入器は常に清潔で乾燥した状態に保ち、汚れたらマウスピース (吸入口) を乾いた布かティッシュペーパー等でいねいに拭いてください。矢印部分を押しすとマウスピースが回ってしまうことがありますので、拭く際には矢印部分を押しさないように気をつけてください。
- 2) この吸入器は乾燥した粉末状の薬剤を吸入するものです。吸入器を水で洗ったり、湿ったもので拭いたりしないよう気をつけてください。
- 3) 吸入器は室温で乾燥した場所に保管してください。
- 4) 小児の手の届かないところで保管してください。

注意事項

- ①この薬は吸入薬です。飲み薬ではありません。
- ②医師が指示した回数にしたがって、吸入してください。
- ③この薬は喘息の発作を速やかに抑える薬ではありませんので、緊急時には使用しないでください。
- ④症状が改善しても、医師の指示がない限り、自分の判断で吸入量を減らしたり、中止したりしないでください。
- ⑤医師が指示した吸入法・吸入量を守っていても、万一発作が起きた場合は、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ⑥他の薬を同時に使用する場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。

「アズマネックス® ツイストヘラー®の吸入法」については、裏面をご覧ください。

製品に関するお問い合わせは、弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

お電話によるお問い合わせ

オルガノン株式会社カスタマーサポートセンター 東京都港区南青山1-24-3

フリーダイヤル 0120-095-213 【受付時間:9:00-17:30
(土日祝日・当社休日を除く)】

●その他ご不明な点は、医師、薬剤師にご相談ください。

アズマネックス[®] ツイストヘラー[®] の吸入法 きゅう にゅう ほう

ステップ1

キャップをはずします

◆吸入器をまっすぐ立てて持ち、キャップを左に回してはずしてください。

注1) 吸入器をまっすぐ立ててキャップをはずしないと、1回分を正確に吸入できません。

注2) キャップを指で回せない場合は、手で握って回してください。

注3) キャップをはずした後、マウスピース（白い吸入口）は決して回さないでください。無理に回すと本体部の矢印と残量計の位置が合わなくなり、薬の吸入ができなくなります。

◆キャップをはずすと吸入器に薬が充てんされて、残量計の数が一つ減り、使用後の薬の残量が表示されます。



残量計の拡大図

ステップ2

薬を吸入します

◆息を吐ききってから、マウスピース（吸入口）を口にくわえ、水平にして唇をしっかり閉じて、強く、深く、息を吸いこんでください。微粉末の薬を吸入します。吸入時には空気口をふさがないようにしてください。

吸入器を口から離し、無理をしない程度に軽く息を止めてください。

◆吸入後は必要に応じてマウスピースを拭いて乾かしてください。

注) マウスピースに息を吹きこまないでください。



【正しい使い方】

1) 吸入するたびに、**ステップ1** と **ステップ2** を確実に行ってください。

2) 吸入後はキャップをはめ、カチッと音がするまで、少しだけ力を入れて押しながら右に180度回し、残量計とキャップポインターの位置が確認してください。

注1) 矢印と残量計の位置がずれている場合は、矢印を残量計の真上に移動させてから、キャップをはめてください。

位置がずれたままキャップをはめると、キャップがはずれなくなることがあります。

注2) 品質保持のためキャップをきちんとはめてください。

注3) カチッと音がするまではめないと、次回の吸入の準備ができません。

注4) 吸入時以外はキャップをはずさないでください。キャップをはずすたびに薬の残量が減っていきます。

3) 吸入後は必ずうがいをするか、口をすすいでください。

■使用上のポイント

◆匂い、味はほとんどありませんので吸入の感覚がないことがありますが、医師の指示がない限り、余分に吸入しないでください。

◆医師の指示に従って、毎日正しくご使用ください。

◆吸入器に異常を感じた場合は、いったん使用を中止し、吸入器を持参して医師又は薬剤師にご相談ください。

